

FACES: Logiciel de réservation en ligne

Les plateformes BMM
Groupe BISTROP

Auteurs: Monique Vasseur, Audrey Noël et Louise Courmoyer

Guide de l'utilisateur v.2016

Les plateformes BMM

Accueil / Plateformes scientifiques BMM

Microscopie photonique
Protéomique et génomique
Cristallographie biomoléculaire
Imagerie de gels et blots
RMN biomoléculaire
Ultracentrifugation
Spectrophotométrie
Stérilisation, eau osmosée et compteurs à scintillation
Informations générales et tarification

Appareils incorporés à
la réservation en ligne

PLATEFORMES SCIENTIFIQUES BMM

RÉSERVATION EN LIGNE



Microscopie photonique



Protéomique et
génomique



Cristallographie
biomoléculaire



Imagerie pour gels et
blots



RMN biomoléculaire



Ultracentrifugation



Spectrophotométrie



Stérilisation, eau osmosée
et compteurs à scintillation



Informations générales et tarification

Microscopie Photonique

Plateforme de microscopie

- Microscope confocal à haut débit pour plaque multi-puits et lames **IN CELL ANALYZER 6000** de GE
- Microscope inversé à épifluorescence avec incubateur opaque **NIKON TE2000E**
- Microscope inversé à épifluorescence **NIKON TE2000U**
- Microscope inversé confocal **Olympus FV300**
- Microscope super résolution inversé Diskovery Flex System de **Quorum Techn.** (3D PALM)
- Microscope super résolution inversé **Elyra SP.1** de Zeiss (SR-SIM, 3D PALM, dSTORM)
- Microscope inversé à disque rotatif Axio Observer **Z1** de Zeiss (SPINNING DISK)
- Microscope droit à épifluorescence motorisé Axio-Imager **Z2** de Zeiss
- Station imagerie; Ordinateur 8 processeurs 64bits dédié à l'imagerie



Microscopie photonique

Formation obligatoire

par Monique Vasseur

Monique.vasseur@umontreal.ca

local D-333 tel 5148

Choose a Schedule

M_IN_CELL_6000
M_NIKON_TE2000E
M_NIKON_TE2000U
M_OLYMPUS_FV300
M_QUORUM_SR
M_STATION_IMAGERIE_1
M_ZEISS_ELYRA
M_ZEISS_Z1_SPIN_DISK
M_ZEISS_Z2_DROIT

Cristallographie

Plateforme de cristallographie

- Incubateur de cristallisation: **Centee TG 40** *temperature gradient crystallizer*
- Micro-pipetage manuel: **Fluid-X** i-Pette
- Robot de nano-pipetage: **Mosquito**
- Robot imageur et de cristallisation: **CRYSTAL Pro-HT** de Molecular Dimensions
- Source lumineuse UV: **X-TA Light UV** de Molecular Dimensions

Formation obligatoire

par Benoit Bessette

benoit.bessette@umontreal.ca

local B-329 tel 1929



Choose a Schedule

Choose a Schedule

C_CENTEO
C_FLUIDX
C_MOSQUITO
C_PRO_HT
C_XTA_UV

Protéomique et Spectroscopie

Plateforme de protéomique et génomique

- **Lecteurs de plaque multi-puits:**
 - Fusion α -FP de Perkin-Elmer: fluorescence, luminescence et absorbance
 - SpectraMAX 190 de Molecular Devices: absorbance
 - SpectraMax Gemini XS de Molecular Devices: fluorescence et luminescence
- **Luminomètre Triathler de HidEX** (Lectures de tubes de 7 ml, 20ml et eppendorf)
- **qPCR en temps réel:**
 - LightCycler 480 de Roche
 - LightCycler 96 de Roche

Plateforme de Spectroscopie

- Spectrophotomètre pour fluorescence **Cary Eclipse** de Varian-Agilent
- Spectrophotomètre UV-Visible **Cary 300** de Varian-Agilent

Formation obligatoire

par Philipe Lampron

p.lampron@umontreal.ca

local A-311 tel 5560



Choose a Schedule

- P_FUSION
- P_LUMIN_TRIATHLER
- P_QPCR_LC480
- P_QPCR_LC96
- P_SPECTRAMAX_190
- P_SPECTRAMAX_GEMINI



Choose a Schedule

- SPECTRO_FLUO_CARY_ECLIPSE
- SPECTRO_UV_VIS_CARY300

Ultracentrifugeuses et rotors

Plateforme d'ultracentrifugation

- Ultracentrifugeuse **Beckman L8-70M**
- Ultracentrifugeuse **Sorvall Thermo Discovery 100SE**
- Micro-ultracentrifugeuse **Sorvall Discovery M-150**
- Ultracentrifugeuse **Sorvall Thermo WX90**
- Ultracentrifugeuse **Sorvall Thermo WX100** (grise)
- *Les rotors sont décrits sur le site du département*

Formation obligatoire

par Louise Cournoyer

louise.cournoyer@umontreal.ca

local G-335 tel 4813



Choose a Schedule

- ROTOR_B_NVT65
- ROTOR_B_SW28_8373
- ROTOR_B_SW_28
- ROTOR_B_SW_50_1C
- ROTOR_S100_AT6
- ROTOR_S150_AT
- ROTOR_S_65V13
- ROTOR_S_AH629
- ROTOR_S_AH650
- ROTOR_S_T1250
- ROTOR_S_T1270
- ROTOR_S_T647_5
- ROTOR_S_TH641
- SPECTRO_FLUO_CARY_ECLIPSE
- SPECTRO_UV_VIS_CARY300
- ULTRA_B_L8_70M
- ULTRA_S_100SE
- ULTRA_S_MICRO150
- ULTRA_S_WX90
- ULTRA_S_WX_ULTRA100



FACES Scheduling System

- Accès web tant à l'interne qu'à l'externe de l'UdeM
- <http://www.biochimie.umontreal.ca/plateformes-scientifiques-bmm/>
- Seuls les utilisateurs autorisés (formés) ont la possibilité de réserver les appareils
- Logiciel développé et hébergé à l'*University of Georgia*

Demande d'accès à la réservation en ligne

- Pour toute demande d'ouverture de compte, veuillez fournir votre adresse de courriel et votre laboratoire d'appartenance à:

Monique Vasseur, responsable du système

monique.vasseur@umontreal.ca

Tél. (514) 343-6111 poste 5148


En son absence, à Audrey Noël

audrey.noel@umontreal.ca

Tél. (514) 343-6111 poste 42529

Comment y accéder ?

<http://biochimie.umontreal.ca>

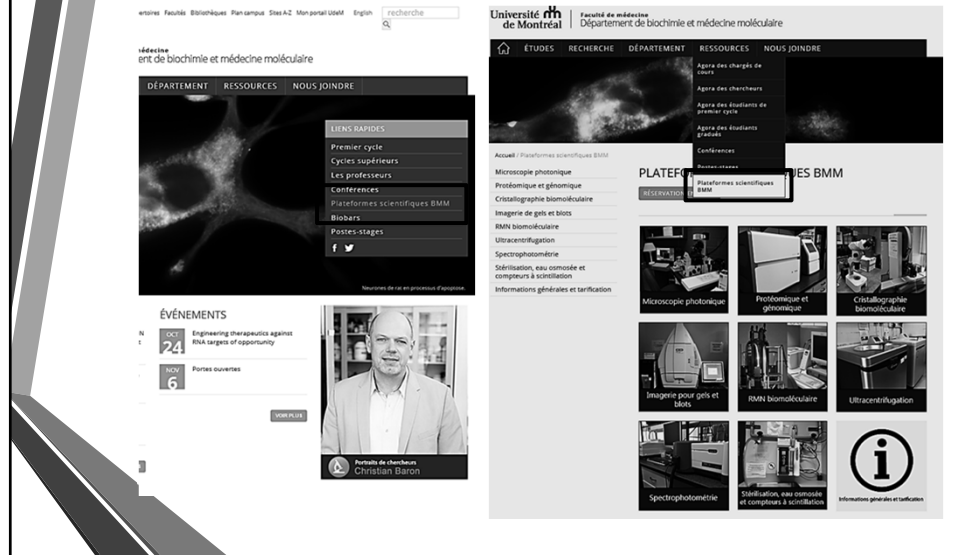

Informations par plateforme



FACES – Page d'accueil

Group: BISTROP

User name: il vous sera fourni par Monique Vasseur ou Audrey Noël, administratrices du groupe BISTROP

Password: vous recevrez un courriel vous fournissant un mot de passe temporaire que vous aurez à changer à la première visite sur *Faces Scheduling System*

Une fois connecté...

- *Password* permet de changer votre mot de passe



- **News :** les dernières nouvelles des plateformes BMM
 - Arrêt de disponibilité pour entretien
 - Formation de groupe
 - Nouveaux équipements
 - ...

Mot de passe oublié

Faces Scheduling System

Please *completely* fill out the following form so we can look up your login information.

Your group name:

Your email:

If you cannot remember the name of your Faces scheduling group, ask the group manager.

Login Here

Group:

User Name:

Password:

*Check boxes to save your Login Information.
Do not save your password if you are using a computer that others can access.

☐ Save*

If you forget your password [Click here](#)

Fournir la même adresse courriel que celle à laquelle vous avez reçu le premier mot de passe temporaire.

Si vous voulez changer d'adresse courriel, contacter monique.vasseur@umontreal.ca

Choisir un appareil

Choisir l'appareil à réserver dans la liste déroulante : **"Choose a Schedule"**.

À noter que la liste des appareils disponibles à la réservation en ligne est individuelle et qu'elle reflète les permissions que vous avez.

Pour avoir accès à un nouvel appareil/service, il faut céder une formation avec le responsable de cet appareil/service.

faces.uce.ugm.edu/condex/login.php

Choose a Schedule

C_MOSQUITO

C_PROJIT

C_XTA_UV

M_IN_CELL_6000

M_NIKON_T2000E

M_NIKON_T2000J

M_OLYMPUS_FV300

M_OUQUUM_SK

M_STATION_IMAGERIE_1

M_ZEISS_ELYRA

M_ZEISS_Z1_SPIN_DISK

M_ZEISS_Z2_DROIT

PORTABLE_NOIR

PORTABLE_OR

P_FUSION

P_LUMIN_TRIATHLER

P_QPCR_IC480

P_QPCR_IC96

ROTOR_B_45_TI

ROTOR_B_50_TI

Bonjour et bienvenus sur le site de l'Université de Montréal. Si vous êtes en personne (local D-333), merci!

News Password Help Logout

monoverl

Scheduling System

Account 'BISTROP'

BISTROP du département de biochimie et médecine
Si vous souhaitez obtenir un code, veuillez contacter Monique Vasseur (5148) ou par courriel (monique.vasseur@umontreal.ca).

Calendrier de réservation

Systeme confocal a haut debit pour plaques multipuits et pour lames IN CELL ANALYZER 6000 de GE, local D-509. Responsable: Dr Stephen Michnick, chercheur

Choose a Schedule · News · Password Help · Logout

24

Hints appear here only for devices with a mouse

2014	Sun Nov 16	Mon Nov 17	Tue Nov 18	Wed Nov 19	Thu Nov 20	Fri Nov 21	Sat Nov 22
08:00							
10:00							
12:00							
14:00							
16:00							
18:00							
20:00							

Choisir une plage horaire en cliquant une fois au début de la plage puis survoler avec la souris (mais sans garder le bouton enfoncé) sur la plage à réserver .
Re-cliquer une fois dans la plage pour finaliser le choix.

Confirmation/annulation de votre réservation

1- Vérifier votre réservation

have requested a new appointment:
Start Time: Thu 2014-11-20 09:00:00
End Time: Thu 2014-11-20 11:00:00
Comment:

2- Laisser un message/commentaire qui sera lié à la séance que vous venez de réserver

Option: none

3- S'il y a lieu, choisir une option ou appareil accessoire nécessaire

ou Annuler

4- Confirmer votre réservation en appuyant OK, vérifier le tableau

2014	Sun Nov 16	Mon Nov 17	Tue Nov 18
08:00			
10:00			
12:00			

Voir qui a déjà réservé

Systeme confocal a haut debit pour plaques multipuits et pour lames IN CELL ANALYZER 6000 de GE, loc D-509. Responsable: Dr Stephen Michnick, chercheur

Reserved by quendo from Fri 2014-11-21 10:00:00 to Fri 2014-11-21 13:00:00

Placer (sans cliquer) le curseur par dessus d'une plage pour en voir les détails au-dessus du calendrier à droite

Voir tous les détails d'une réservation

Tous les détails d'une réservation

Return To Calendar

manager has reserved an appointment at this time.

Starting: 2015-10-30 08:00:00
Ending: 2015-10-30 12:00:00

Comment: BCM3531

Option: none


Delete This Appointment

email manager


email

Clicker une fois sur une plage pour voir tous les détails de la réservation (qui apparaitront dans une nouvelle fenêtre)

Envoyer un message à celui qui a réservé

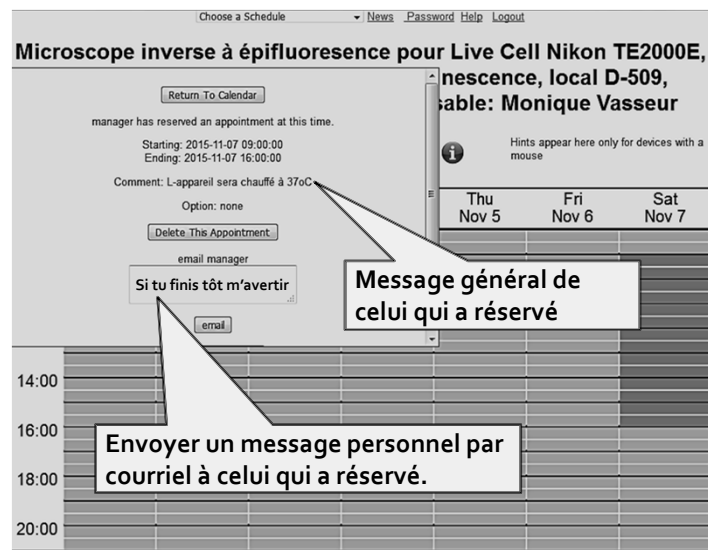

Annuler votre Réservation

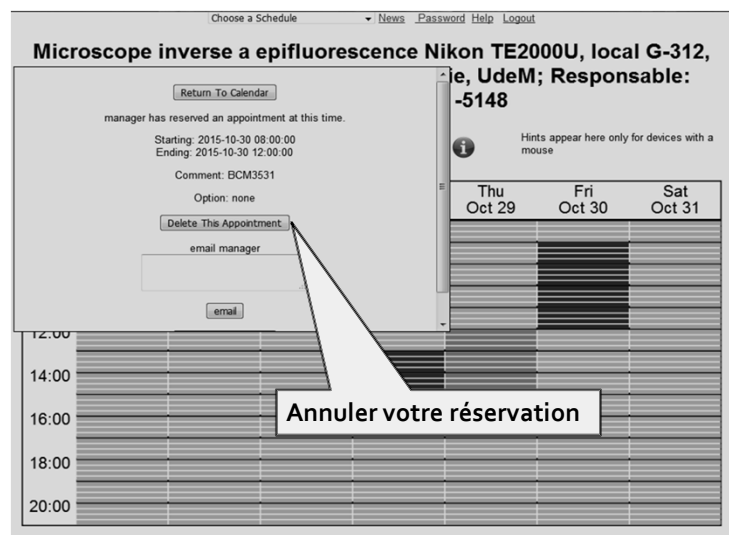

Commentaires?

Pour toute demande de support ou pour nous faire
parvenir vos suggestions/commentaires,
n'hésitez pas à nous contacter.

Monique Vasseur, responsable du système
monique.vasseur@umontreal.ca
Tél. (514) 343-6111 poste 5148